

ONDERHOUD DOOR DE GEBRUIKER VAN HET BLAUWE LIJN MEETTOESTEL EN DE STANDAARD CONDENSAFSCHEIDER


REINIGEN EN CONTROLE VAN UW BLAUWE LIJN MEETTOESTEL

Reinig de behuizing van de meter en het holster niet met een schuurmiddel of oplosmiddel, maar maak gebruik van een vochtige doek met een zacht schoonmaakmiddel.


Controleer regelmatig of de connectoren niet beschadigd of vervuild zijn en of de gasslangen niet gescheurd, beschadigd, verstopt of lek zijn.

ONDERHOUD VAN DE STANDAARD CONDENSAFSCHEIDER

Vervang de stoffilter van de condensafscheider als deze vervuild of erg nat is. Als de stoffilter niet te vervuild is, kan deze worden herbruikt na het spoelen met koud water. Let op, de filter moet helemaal droog zijn alvorens te herbruiken. Controleer ook regelmatig de PTFE-filter. Haal voorzichtig het gedeelte met de filter van het middenstuk af en draai nadien de laatste delen van het patroon van elkaar om bij de filter te kunnen. De PTFE-filter behoort wit te zijn. Indien dit niet het geval is, is de filter aan vervanging toe. Een PTFE-filter moet met het raster naar buiten (en dus de gladde kant naar binnen) geplaatst worden omdat enkel zo het water kan tegengehouden worden. Opgelet, plaats de O-ring terug voordat u het eindstuk er weer opschroeft.

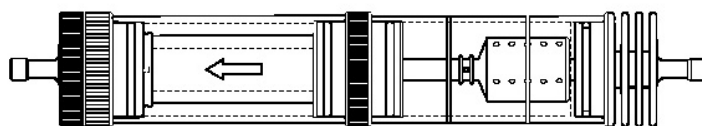


CONTROLE PTFE-FILTER

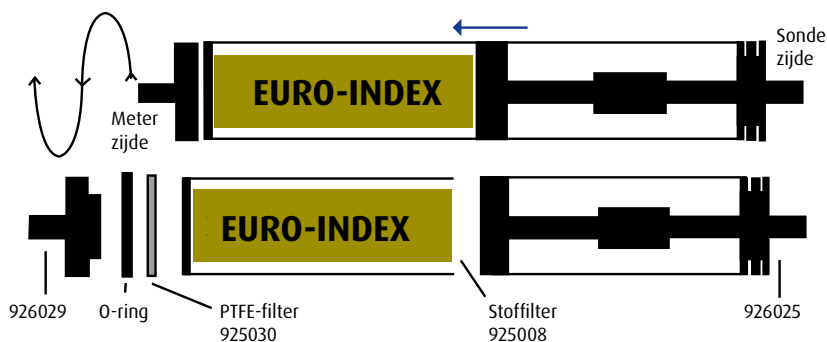

LEGEN VAN DE CONDENSAFSCHEIDER

Tijdens een meting kan condenswater in de condensafscheider komen. Leeg het reservoir als de meting wordt gestopt en als het condenswaterniveau boven één gele streep komt. Als het condenswaterreservoir niet tijdig wordt geleegd, kan dit de meting beïnvloeden en in het slechtste geval leiden tot schade aan de meter.

Let er ook goed op dat de blauwe pijltjes die op de condensafscheider staan in de juiste richting wijzen. Deze pijltjes geven de richting aan van de rookgassen en wijzen naar de meter toe.

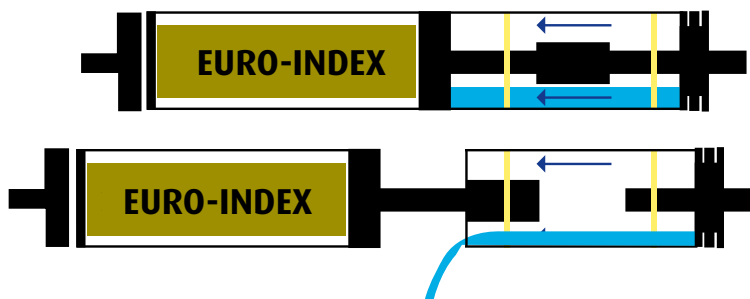

KALIBRATIE EN ONDERHOUD DOOR EURO-INDEX

Het periodiek laten testen van meetinstrumenten kan zorgen voorkomen. Zo kan de betrouwbaarheid van de uitgevoerde metingen in vraag worden gesteld wanneer er nadien afwijkingen in de nauwkeurigheid van de meter worden ontdekt (productaansprakelijkheid).

Om deze reden adviseert EURO-INDEX meetinstrumenten periodiek te (laten) testen. Onze productspecialisten kunnen u hierover uitgebreid informeren.